

STRUMENTO RADIONICO



New Orgo-Radionico

Ricarica vitale con energia organica

New Orgo-Radionico

Nuova versione predisposta a trattamenti in presenza.

Trattamenti Radionici (con testimoni fotografici) per la ricarica energetica organica e il rilascio delle energie congeste (DOR).
Essenziale la luce del sole per l'utilizzo.

Lo strumento è disposto per:

- *Ricarica organica a distanza*
- *Ricarica organica in presenza (con Base-Transfer)*
- *Ricarica organica per animali, piante, prodotti ed alimenti*
- *Rilascio energie eteriche congeste (DOR)*

Corredato da:

- libretto di istruzioni

MISURE cm 15x15x10,5(h)

PESO gr 830


CARATTERISTICHE TECNICHE

Il dispositivo Orgo-Radionico è stato realizzato dalla nostra bottega artigianale Radionica per Operatori radiestesici che vogliono un supporto potente ed efficace, ma soprattutto naturale! **Estremamente utile per rispondere a disturbi di origine psichica, quali: stress, nevrosi, esaurimento, ecc...**

È composto da una base in compensato marino e da una lamina in alluminio ove vengono appoggiate le fotografie della persona che si vuole trattare.

L'Orgone è realizzato con una massa metallica avvolta da filamenti di lana.

La manopola collegata ad un potenziometro, presente all'interno dello strumento, serve per regolare la fuoriuscita di energia congesta. Questo avviene a qualsiasi distanza si trovi il soggetto dallo strumento, come avviene del resto con tutti gli strumenti radionici.

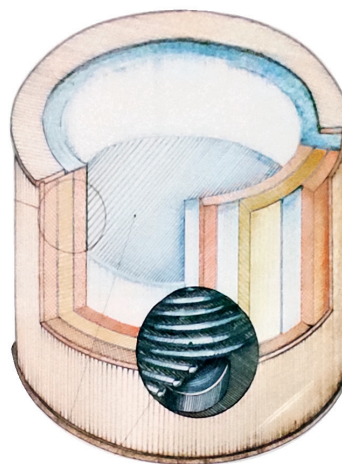

*Accumulatore Organico
modificato da W. Reich*

Ancora una volta la Radionica è al servizio dell'Essere umano!


Con il ritmo della vita di oggi facciamo sempre più fatica a trovare del tempo da dedicare a noi stessi, per questo abbiamo pensato all'Orgo-Radionico che ci ricarica mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane.

L'**Accumulatore Organico**, costruito secondo i principi del progetto di W. Reich, riceve energia dal cosmo per caricarsi. Ecco perchè è importante **tenerlo esposto al sole**, o alla luce naturale, durante il suo utilizzo.

Dall'accumulatore fuoriesce l'energia organica accumulata, tramite un filamento di lana atto a non fare disperdere l'energia organica nel trasferimento dall'accumulatore allo strumento stesso.

L'energia organica viene assorbita dai filamenti di lana, poi trasferita alla parte metallica dove si accumula. Questa energia viene poi trasmessa, tramite un filo di seta, ad un circuito all'interno dello strumento, che a sua volta è collegato alla piastra in alluminio rossa.

Il **testimone** consiste in due fotografie uguali (formato tessera): la prima si posiziona sulla piastra metallica di destra (rosso) con l'immagine rivolta verso l'alto, la seconda si posiziona sulla piastra di sinistra (azzurro) con l'immagine rivolta verso il basso, rispettando le due polarità del corpo.

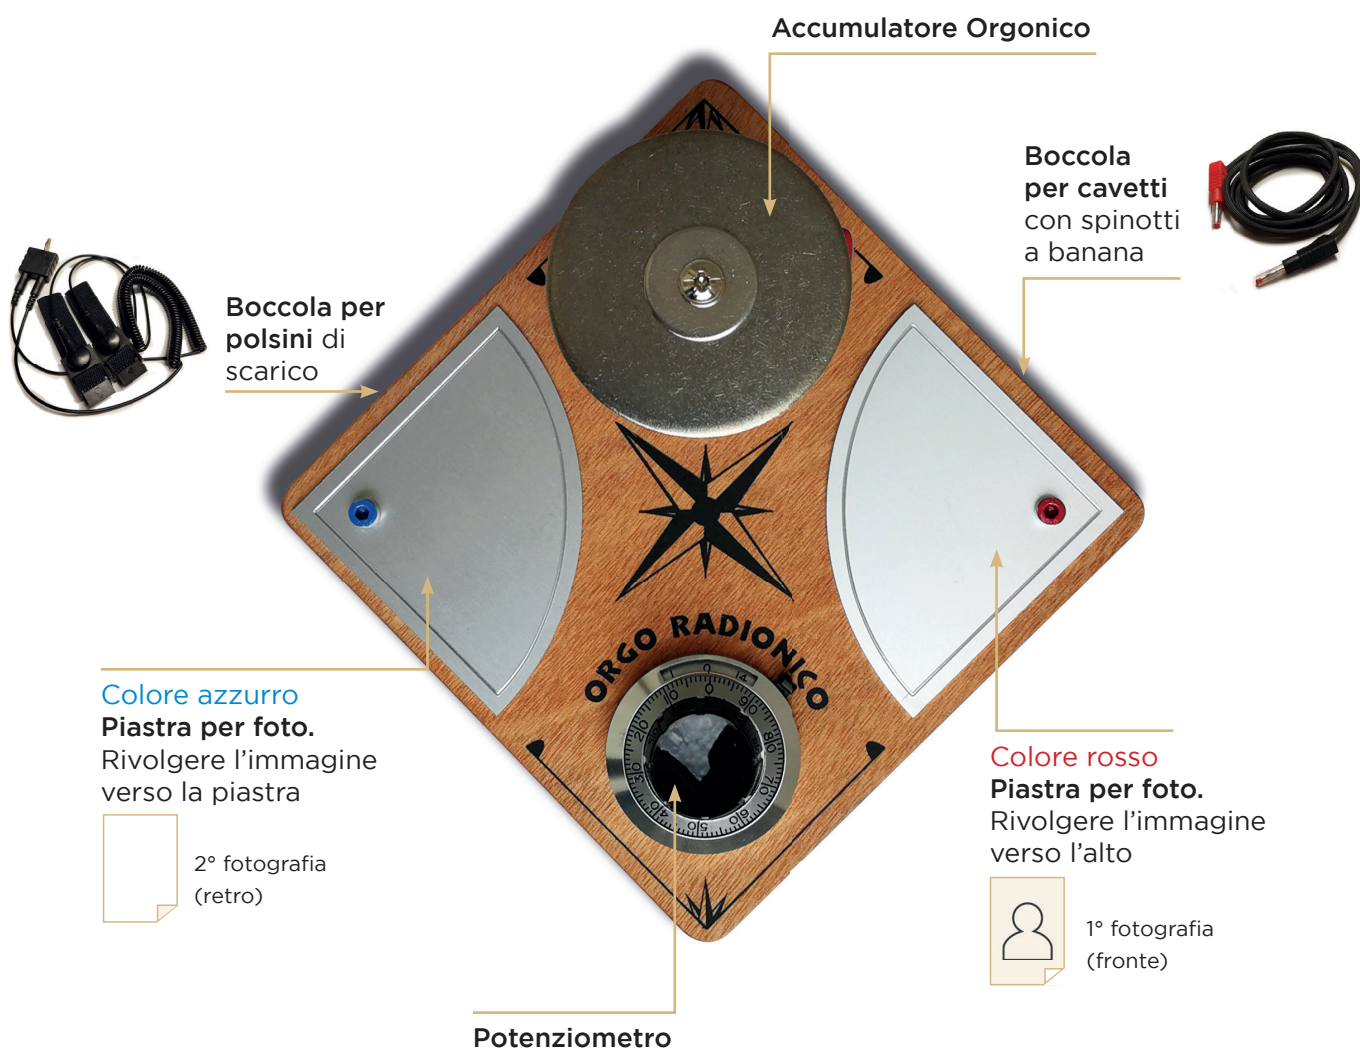

PER UN MIGLIOR ASSORBIMENTO

Orgo-Radionico

Non abusatene oltre il tempo che vi viene indicato radiestesicamente.

Per un miglior assorbimento Orgo-Radionico, sarebbe opportuno che la persona, mentre riceve il trattamento, sia in uno stato di consapevolezza e attenzione e non di dispersione.

Per coloro che coltivano la propria spiritualità, un assetto di preghiera di ringraziamento sarebbe opportuno, poiché l'Orgone è energia vitale, donata dal cosmo all'Essere umano per il suo buono stato di salute.

Considerando inoltre che stress, depressione ed esaurimento sono la condizione del nostro stato psichico, si consiglia di arricchire ogni trattamento Orgo-Radionico con **pensieri di pace, di positività alla vita e, soprattutto, di Amore per ogni essere vivente.**

Lo strumento Orgo-Radionico non ha bisogno di manutenzione tecnica, ma solo di **pulizia** sulle piastre, **positività** della mente e **costanza** nell'eseguire i trattamenti.

Testimone

Consiste in due nostre fotografie (formato tessera): la prima si posiziona sulla piastra metallica di destra (●) con l'immagine rivolta verso l'alto, la seconda si posiziona sulla piastra di sinistra (●) con l'immagine rivolta verso il basso, rispettando le due polarità che abbiamo in corpo.

La 1° fotografia, riceve l'energia Orgonica accumulata dallo strumento attraverso la piastra metallica e la trasmette al soggetto originale per l'effetto di Risonanza (che avviene tra la fotografia e la persona).

La 2° fotografia, essendo anch'essa in Risonanza con la persona in trattamento, trasmette alla piastra il "DOR" (energia corporea congesta del soggetto), e la trasporta all'interno dello strumento, ove si trova un "Translatus" collegato ad un potenziometro che controlla l'uscita del DOR stesso, orientandolo fuori dalla stanza in cui è posizionato.



QUANDO E' BENE UTILIZZARLO

È consigliato in vari ambiti: per la ripresa post operazioni chirurgiche, per insufficienze d'organo, malattie autoimmuni, infezioni parassitarie (virus, funghi, metazoi, protozoi) ed allergie, stati depressivi o di esaurimento mentale.

È sconsigliato per: persone elettrosensibili, che seguono chemio o radio-terapia, affette da alcune tipologie di tumori (è necessario testare radiestesicamente la compatibilità per il singolo caso).

AGGIORNAMENTO 2025

Orgo-Radionico è stato aggiornato con una nuova boccola per il collegamento a due cavetti con spinotti a banana, per collegare stuoie di biorisonanza e altri accessori compatibili a trattamenti Radionici in presenza!

Con questa modifica sarà possibile caricare di energia organica prodotti anche di grandi dimensioni e fare trattamenti Radionici in presenza, agendo contemporaneamente su CORPO, MENTE e SPIRITO.

Sarà sempre necessario inserire nelle piastre le 2 fotografie per il trattamento Radionico durante il trattamento organico in presenza (sia con prodotti che con persone).

La potenza ed i tempi di azione sono esponenzialmente superiori e più efficaci!

UTILIZZO ORGO-RADIONICO CON BASE-TRANSFER

Base-Transfer è un supporto e pedana per effettuare il trasferimento di energia organica dallo strumento ad un prodotto desiderato o per realizzare trattamenti organici in presenza.

Orgo-Radionico può essere utilizzato con Base-Transfer in 2 modalità:

- 1 Caricare energia Organica su prodotti, anche di grandi dimensioni**
(necessaria 1 Base-Transfer)



- 2 Trattamenti Organici in presenza**
(necessarie 2 Base-Transfer)



I cavi di collegamento sono a corredo con l'accessorio Base-Transfer per il trattamento organico.

Su richiesta, sarà possibile aggiornare gli strumenti Radionici "Orgo-Radionico" precedenti ad ottobre 2025. Costo di 70,00 euro.

(cavo non incluso e spese di spedizione a carico del cliente)